


No	サンプル名	回帰式	標準偏差 $\sigma$	相関係数
○ 1	焼却灰・A	$Y = 4,151.497 \cdot X^3 - 1,688.410 \cdot X^2 + 219.411 \cdot X - 0.016$	0.34	0.9965
□ 2	焼却灰・B	$Y = 5,082.020 \cdot X^3 - 1,666.569 \cdot X^2 + 198.675 \cdot X + 0.918$	0.32	0.9968
△ 3				
× 4				
◇ 5				
● 6				
▲ 7				
✱ 8				
■ 9				

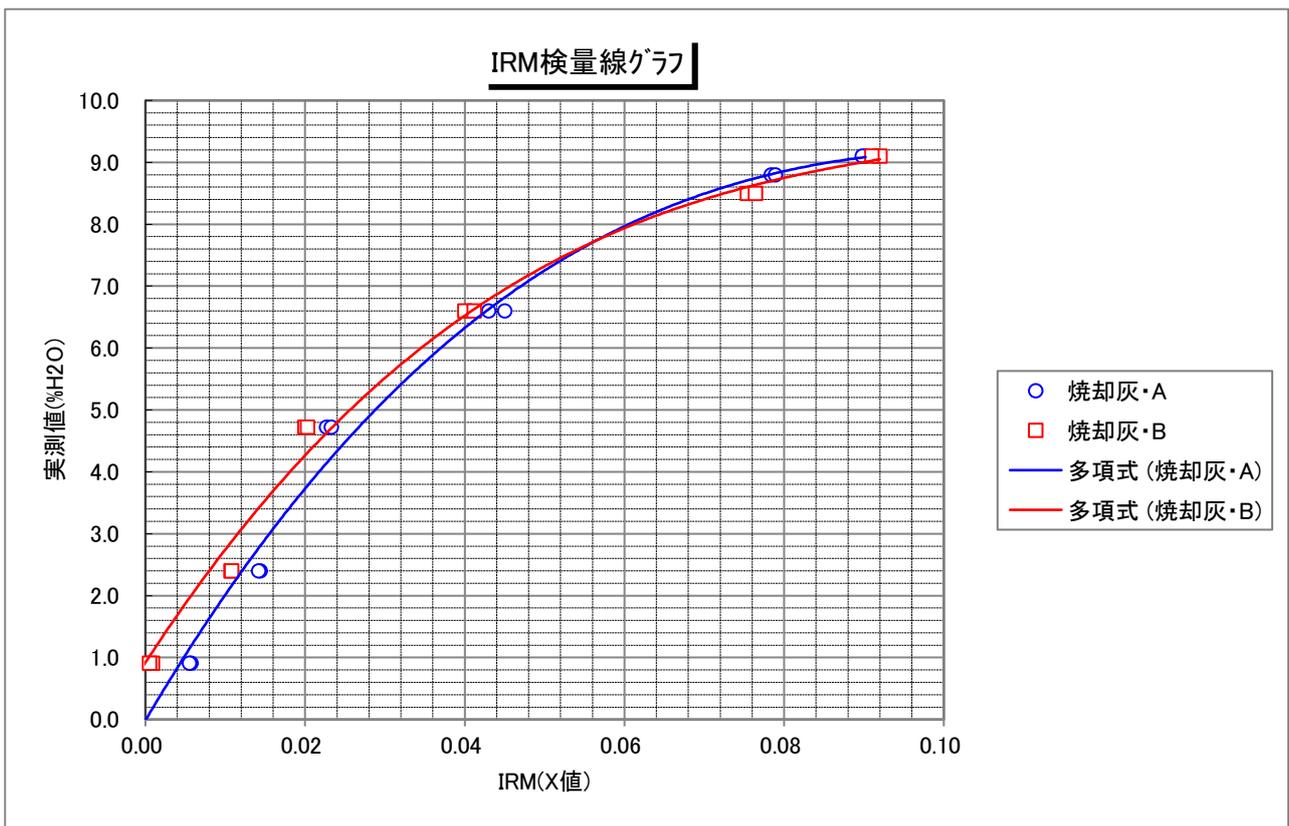

\*検量線係数 $a_0 \sim a_3$ は回帰式の0~3次の係数に該当(有効桁数は5桁、それ以下は四捨五入)